Teste de diagnóstico rápido (TDR) para deteção de cólera

Crystal® VC 01/0139, Arkray - Método da vareta



Guia de Referência Rápida Para obter instruções mais detalhadas, consulte a bula do fabricante

Indicações para uso

- Os TDRs não são usados para diagnóstico individual
- TDRs são usados para vigilância para 1) acelerar a deteção e 2) monitorização de surtos
- Considere a estratégia de teste aplicada atualmente em sua área
- Execute TDR em amostras de fezes frescas, dentro de 2 horas após a coleta

Antes de começar


- Verificar datas de validade e condições de armazenamento
- Certifique-se de que todos os componentes do kit estão à temperatura ambiente antes do teste
- Desinfete o espaço de trabalho
- Usar equipamento de proteção individual adequado. Usar luvas novas ao manusear fezes para TDRs

No final

- Coloque todos os resíduos num saco de risco biológico com revestimento duplo ou num contentor para objetos cortantes, desinfete o espaço de trabalho
- Retire as luvas e lave as mãos
- Registar todos e quaisquer resultados de TDR num registo em papel ou eletrónico
- Relatar todo e qualquer resultado de TDR, incluindo resultados inválidos e não reativos
- As amostras podem ser transportadas para testes adicionais com base na estratégia de teste

Rotule o frasco para injetáveis de processamento da amostra com o identificador do doente e abra a tampa.











Amostras fecais líquidas: Retirar

amostras líquidas utilizando o

conta-gotas e transferir 2 gotas






Retire a tampa transparente e parta a ponta azul (aponte e cubra com lenço de papel para evitar salpicos).



Introduzir 4 gotas de amostra transformada num tubo de ensaio de 5 ml rotulado



Aguarde 15-30 minutos e leia o resultado..




Para mais informações

Formulários de referência e relatórios do GTFCC


Aplicação móvel GTFCC

Formação:

Recolha de amostras e testes com Testes de Diagnóstico Rápido da cólera para profissionais de saúde

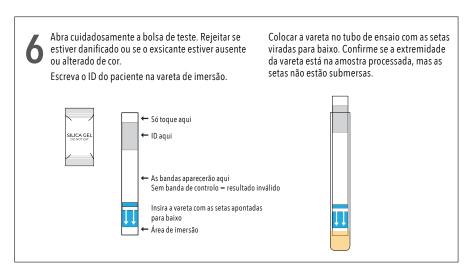

V3.0 setembro 2025 Página 1 de 2

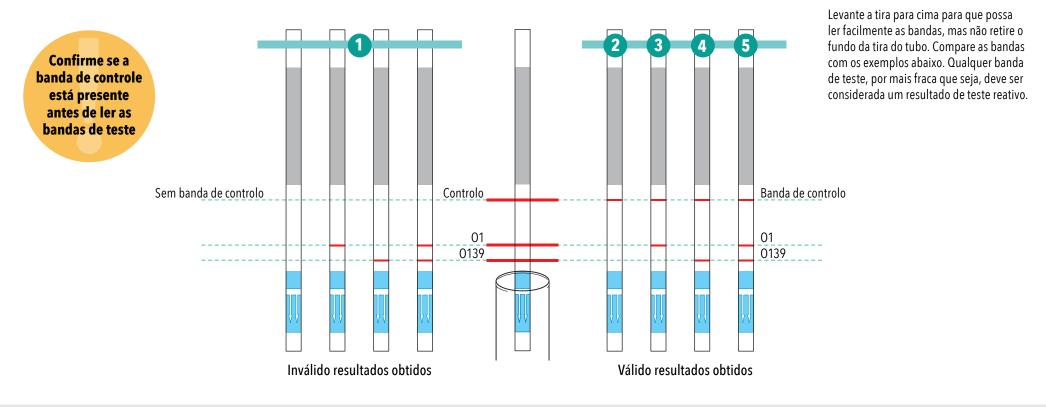

RESULTADOS E AÇÕES

Registe todos os resultados no(s) registo(s) adequado(s) e comunique os resultados finais no formulário adequado de gestão de casos e nos formulários de encaminhamento laboratorial.

	Bandas de teste	Resultados	Açãos
0	Sem banda de controlo	Inválido	Repetir usando um novo teste
2	Apenas banda de controlo	Não reativa	Relatório como VC não reativo
3	Controlo da banda VC O1	VC O1 reativo	Relatório como VC O1 reativo
4	Controlo da banda VC 0139	VC 0139 reativo	Repetir o teste, se o 2º resultado for o mesmo, reporte como VC O139 reativo. Enviar amostra para laboratório para testes adicionais
5	Controlo & VC O1 & VC O139	VC O1 & VC O139 reativo	Repetir o teste, se o 2º resultado for o mesmo, reporte como VC O1 & VC O139 reativo. Enviar amostra para laboratório para testes adicionais

Vibrio cholerae O139 é incomum fora do Sudeste Asiático, Se o RDT mostra uma banda para O139 deve ser considerado no contexto - a área em que você está e se houver um surto atual de VC O139. Quando o O139 é um resultado inesperado, são sempre necessários mais testes.