

دوعي الاستخدام

- للتشخيص الفردي RDTs لا تستخدم الاختبارات السريعة
- تُستخدم الاختبارات السريعة لأغراض الترصد بهدف (1) تشريح الكشف و(2) متابعة تنشئ الفاشيات
- اعتماد استراتيجية الفحص المطبق حالياً في منطقة
- إجراء الاختبار السريع على عينات براز طازجة خلال ساعتين من جمعها

في النهاية

- ضع جميع النفايات في كيس نفايات خطر
- مزدوج الطبقة أو في حاوية النفايات الحادة، وقم بتعقيم مساحة العمل
- انزع القفازات وأغسل يديك
- سجل جميع نتائج الاختبار السريع في سجل ورقي أو إلكتروني
- ابلغ عن جميع نتائج الاختبار السريع، بما في ذلك النتائج غير الصالحة والنتائج غير الفاعلية
- يمكن نقل العينات لإجراء فحوصات إضافية بحسب استراتيجية الفحص المعتمدة



قبل البدء

- تأكد من تواريخ الصلاحية وظروف التخزين
- احرص على أن تكون جميع مكونات العدة في درجة حرارة الغرفة قبل إجراء الفحص
- قم بتعقيم مساحة العمل
- ارتد معدات الوقاية الشخصية المناسبة، وارتدى قفازات جديدة عند التعامل مع عينات البراز
- لإجراء الاختبارات السريعة


وزع 4 قطرات من العينة
المعالجة في أنبوب اختبار
5 مل ملصق.



قم بازالة الغطاء الشفاف
وكسر الطرف الأزرق
للقارورة.
(وجهه بعيداً وعطيه
بورق مناسب لتجنب
التناحر).




أعد غلق قارورة
معالجة العينة
باحكام ورجها
لخط المحتواة.




3

عينات براز شبه صلبة: اجمع كمية
صغريرة من البراز باستخدام العصا
ووجعها وانقلها إلى الأنابيب الذي يحتوي
على محلول التفاعل.





أو




7

انتظر 15 دقيقة واقرأ النتائج

ضع الشريط الكاشف في أنبوب الاختبار مع توجيه الأسهم
لأسفل. تأكد من أن نهاية الشريط الكاشف مغمورة في
العينة المعالجة. تأكد من أن طرف شريط الكاشف مغمور
في عينة المعالجة، ولكن يجب ألا تكون الأسهم مغمورة.

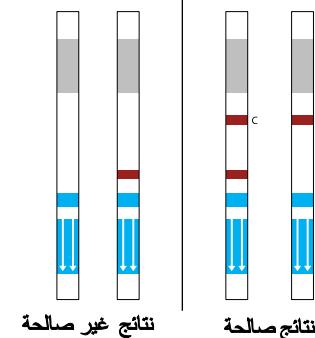

وضع ملصقاً على الأنابيب
به معرف المريض. افتح
غطاء الأنابيب جمع العينة



1

أنبوب جمع العينة


المزيد من المعلومات

[GTFCU referral and reporting forms](#)

[GTFCU mobile application](#)


Training:
[Sample collection and testing with Rapid Diagnostic Tests for cholera for health care workers](#)

افتح كيس الاختبار بعناية. تخلص منه إذا كان
تالفاً، أو إذا كان المحقق مفقوداً أو تغير لونه.
أكتب معرف المريض على الشريط الكاشف

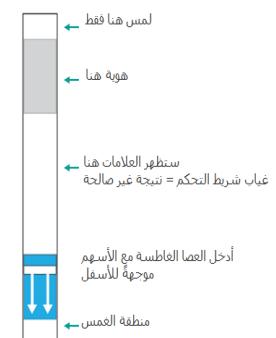

6

الشريط الكاشف - قراءة Crystal® VC O1/O139, Arakray

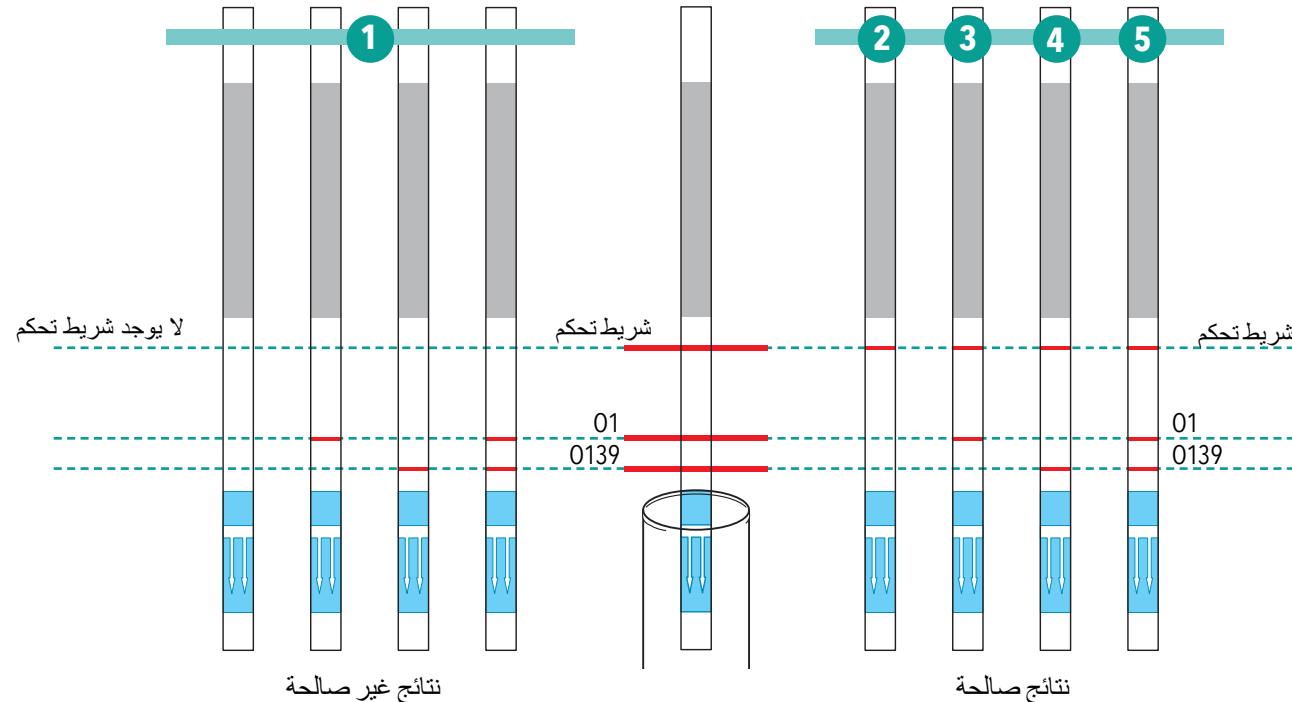

النتائج والإجراءات

سجل جميع النتائج في السجل/السجلات المناسبة، ويبلغ بالنتائج النهائية في استماراة تدبير الحالات والنماذج الخاصة بالإحالة المخبرية

خطوط الفحص	النتيجة	الإجراء
لا يوجد شريط تحكم	غير صالح	أعد الاختبار
شريط تحكم فقط مرئي	غير تفاعلية	أبلغ عن نتيجة اختبار التشخيص السريع غير تفاعلية
شريط تحكم و 01 مرئي	تفاعلية لـ 01	أبلغ عن نتيجة اختبار التشخيص السريع تفاعلية لـ 01
شريط تحكم و 0139 مرئي	تفاعلية لـ 0139	إعادة إجراء الاختبار. في حالة ظهور نفس النتائج، الإبلاغ عن وجود 0139 تفاعلي. إرسال العينة إلى مختبر للتأكد الإضافي
شريط تحكم و 01 و 0139 مرئي	تفاعلية لـ 01 و 0139	إعادة إجراء الاختبار. في حالة ظهور نفس النتائج، الإبلاغ عن وجود 01 و 0139 تفاعلي. إرسال العينة إلى مختبر للتأكد الإضافي

ضنة الكوليرا 0139 غير شائعة خارج جنوب شرق آسيا. فم بتفسير النتائج بناء على الوضع الوبائي في بلدك. عند ظهور 0139 كنتيجة غير متوقعة، يصبح إجراء فحوصات إضافية أمراً ضرورياً دائمةً.